

Stichting Hartveilig Westerwolde

Als Stichting werken wij nauw samen met de Stichting Groningen Hartveilig (GHV) en streven wij naar een levensreddend netwerk van burgerhulpverleners en AED's (Automatische Externe Defibrillator) binnen de Gemeente Westerwolde.

Uitbreiding AED-netwerk in de Gemeente Westerwolde

Stichting Hartveilig Westerwolde

19 oktober 2020

Inhoud

Stichting Hartveilig Westerwolde	2
Over de stichting	2
Doelstelling	2
Samenvatting	2
De juiste AED en buitenkast	2
Inventarisatie geregistreerde AED's	3
Toewijzing AED's	4
Resultaat	5
Aanbevelingen	7

Stichting Hartveilig Westerwolde

Als Stichting streven wij naar een levensreddend netwerk van burgerhulpverleners en AED's (Automatische Externe Defibrillator) binnen de Gemeente Westerwolde.

Over de stichting

De Stichting Hartveilig Westerwolde is ontstaan uit de Stichting Bellingwedde Hartveilig. Na de fusie van de Gemeente Vlagtwedde en de Gemeente Bellingwolde is het werkgebied van de stichting uitgebreid tot de Gemeente Westerwolde en als zodanig ingeschreven bij de KvK. Vanuit de Stichting is er een nauwe samenwerking met de Gemeente Westerwolde. De doelstellingen en activiteiten van de stichting worden omarmd door de Stichting Groningen Hartveilig en HartslagNu, de organisatie welke verantwoordelijk is voor de alarmering van de burgerhulpverleners. Het Bestuur van de Stichting bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers.

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is om binnen de gemeente Westerwolde een sluitend netwerk van AED's beschikbaar te krijgen welke in combinatie met voldoende burgerhulpverleners, in het geval van een hartstilstand, zorgt voor snelle hulpverlening.

Samenvatting

Met subsidiegelden, verkregen van de Eems Dollard Regio (EDR) en de Gemeente Westerwolde, heeft de Stichting Hartveilig Westerwolde het aantal beschikbare AED's in de gemeente kunnen uitbreiden. Bij aanvang van het project constateerden wij dat van de drieënveertig geregistreerde AED's slechts 62% (26) 24 uur per dag beschikbaar waren, 26% (11) alleen gedurende werkdagen buiten schoolvakanties en 12% (5) van de AED's waren inactief.

In de afgelopen maanden zijn na overleg met de gemeente en de betrokkenheid van dorpsbelangen en buurtorganisaties twaalf additionele AED's met buitenkasten door de stichting toegewezen aan nieuwe locaties (witte vlekken), drie bestaande AED's voorzien van een buitenkast en naar buiten verplaatst en vijf AED's met tussenkomst van de stichting door eigenaren naar buiten gebracht en/of geregistreerd. In totaal zijn door deze acties twintig extra AED's aan het netwerk in Westerwolde toegevoegd, waarbij de beschikbaarheid van AED's in de openbare ruimte is toegenomen van 62% (26) naar 80% (46). ¹

De juiste AED en buitenkast

Bij aanvang van het project is door de Stichting Hartveilig Westerwolde bij vijf leveranciers een offerte aangevraagd voor het leveren van tien AED's van het type Cardiac Science G3

¹ Op dit moment worden de laatste AED's geïnstalleerd en geregistreerd

Elite volautomaat en de Philips FRX plus tien buitenkasten van het merk Sixcase SC 1340 met verwarming, alarm en pincode. De keuze voor het type AED en buitenkast is gebaseerd op kwaliteit, betrouwbaarheid, functionaliteit, gebruikersgemak, te openen met pincode/sleutel en bestand tegen vandalisme. Softwareproblemen met de Cardiac Science G3 heeft ons doen besluiten uiteindelijk te kiezen voor de Philips FRX AED. Op basis van de vijf ontvangen offertes is de opdracht tot levering gegund aan laagste aanbieder. Het offertebedrag was 19,3% lager t.o.v. de hoogste aanbieding. ²

Inventarisatie geregistreerde AED's

Het is voor de stichting een uitdaging geweest om een totaaloverzicht te krijgen van alle in Westerwolde geregistreerde AED's. HartslagNu, die beschikte over de gegevens, kon deze om privacy redenen niet verstrekken aan de stichting. Ook de gemeente beschikte niet over een compleet overzicht. Navraag van de gemeente bij HartslagNu leverde niet het gewenste resultaat. De uiteindelijke inventarisatie is door de stichting zelf uitgevoerd, zie figuur 1.




Fig. 1

Van de drieënveertig geregistreerde AED's bij HartslagNu was slechts 62% (26) 24 uur per dag beschikbaar voor de hulpverleners. Daarnaast was 26% (11) alleen gedurende werkdagen en daarvan alleen daguren beschikbaar. Tijdens schoolvakanties waren zes AED's, doordat deze in pandig hingen, niet toegankelijk voor gebruik. Vijf AED's waren inactief. Deze zijn niet direct toegankelijk voor externe hulpverleners. Vanuit de ervaring

² SFP offerte ontvangen 12 feb 2020, alle andere offertes na 18 mar 2020

weten wij dat er daarnaast nog vele AED's binnen bedrijven, instellingen en bij particulieren hangen welke niet bij HartslagNu zijn aangemeld.

De verdeling van AED's per woonkern is in figuur 2 weergegeven.




Fig. 2

Toewijzing AED's

Uit onderzoek is gebleken dat een snelle alarmering, snelle reanimatie en een defibrillatie binnen zes minuten, slachtoffers betere overlevingskansen geven en daarmee een betere toekomst en kwaliteit van leven. Bij de uiteindelijke toewijzing van additionele AED's in de woonkernen is rekening gehouden met deze richtlijn als wel met de beschikbaarheid van hulpverleners in de direct omgeving. Op basis van de inventarisatie en in overleg met de gemeente zijn twaalf omgevingen, witte vlekken, geïdentificeerd waar het wenselijk was op openbare locaties een extra AED op te hangen. Om betrokkenheid vanuit de woonkernen te stimuleren hebben belangenorganisaties in deze woonkernen een verzoek gekregen om voorstellen te doen voor exacte locaties in hun directe woonomgeving.


Uiteindelijk zijn er twaalf nieuwe AED's met buitenkasten geplaatst, zijn er drie extra kasten geleverd aan eigenaren van AED's welke daarmee hun AED naar buiten hebben willen brengen en zijn er met tussenkomst van de stichting nog eens vijf AED's door eigenaren voor eigen rekening naar buiten gebracht en/of geregistreerd. (Rabobank met Dorpsbelangen Vlagtwedde, Waterschap Hunze en Aa's en Gemeente Westerwolde). Zie tabel 1.

Tabel 1:

AED	Kast	Plaats	Adres	Commentaar
X	X	KLEIN-ULSDA	ULSDERWEG / KOUDE HOEK	Geplaatst
X	X	VRIESCHELOO	LAGEWEG	EHBO bevestigd. Zoeken geschikte locatie
	X	WEDDE	DORPSHUIS DE VOORTGANG	Geplaatst
X	X	VLAGTWEDDE	WOLLINGHUIZERWEG	Geplaatst via buurtvereniging
X	X	VLAGTWEDDE	Dr. P. RINSEMASTRAAT	Rechts van de hoofdingang. Via Gemeente
		VLAGTWEDDE	SPORTZAAL, WISCHMEI	Naar buiten verplaatst. Kast door gemeente
		VLAGTWEDDE	SCHOOLSTRAAT/BADWEG	Rabobank AED via Dorpsbelangen plus kast geleverd. Geplaatst
		VEELE	WEDDERSTRAAT	Hunze en AA AED buiten geplaatst plus kast geleverd
X	X	BLIJHAM	EIKENLAAN	Wordt geplaatst
X	X	BLIJHAM	HOOFDWEG	Geplaatst
X	X	BELLINGWOLDE	HOOFDWEG	Geplaatst
X	X	BELLINGWOLDE	SPORTWEG	Geplaatst
		SELLINGEN	KORTEWEG. MFA	Hangt al een AED. Aangemeld door MFA
X	X	SELLINGEN	DORPSSTRAAT	Geplaatst
X	X	JIPSINGBOERTANGE	JIPSINGBOERTANGERWEG DORPSHUIS	Geplaatst
X	X	JIPSINGHUIZEN	WOLLINGHUIZERWEG, BUURTHUIS	Geplaatst
		TER APEL	SPORTHAL	Door gemeente naar buiten verplaatst
X	X	TER APEL	HOOILAND	Afgeleverd
	X	AGODORP	MOLEN A LAAN	Geplaatst. AED door CHD Eefting, kast door Stichting
	X	BOURTANGE	BISSCHOPSWEG	Geplaatst


Resultaat

Door dit project zijn in samenwerking tussen de Stichting Hartveilig Westerwolde, de Gemeente Westerwolde en derden, de kritische “witte vlekken” weggewerkt en totaal twintig extra geregistreerde en voor hulpverleners beschikbare AED’s aan het netwerk in Westerwolde toegevoegd. Tevens is de beschikbaarheid van AED’s in de openbare ruimte toegenomen van 62% (26) naar 80% (46). Zie fig. 3.

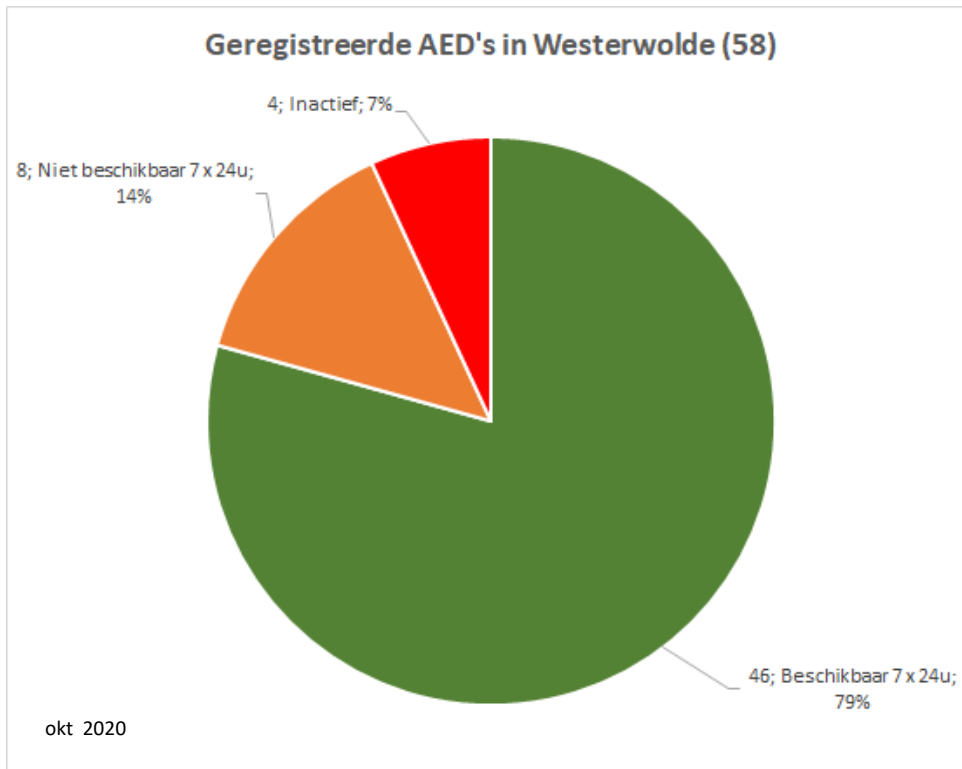

Figuur 3

Met de toewijzing van AED's in de verschillende woonkernen is de verdeling zoals weergegeven in figuur 4.

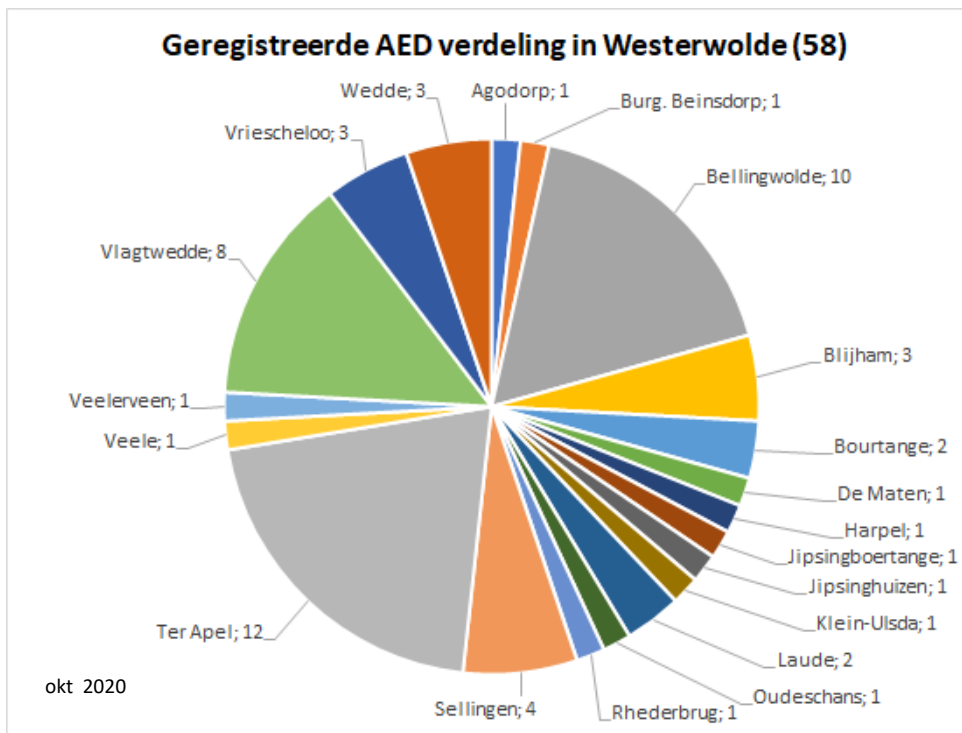

Figuur 4

Zie tabel 2 voor de AED's welke niet 7d/24u beschikbaar zijn dan wel inactief. Vijf van de acht niet beschikbare AED's hangen in scholen, de andere drie bij bedrijven. De inactieve AED's zijn onder beheer van de BHV's van instellingen en één bij een supermarkt.

Tabel: 2


Plaats	Beschikbaar 7 x 24u	Niet beschikbaar 7 x 24u	Inactief	Totaal
Agodorp	1	-	-	1
Burg. Beinsdorp	1	-	-	1
Bellingwolde	8	2	-	10
Blijham	2	1	-	3
Bourtange	2	-	-	2
De Maten	1	-	-	1
Harpel	1	-	-	1
Jipsingboertange	1	-	-	1
Jipsinghuizen	1	-	-	1
Klein-Ulsda	1	-	-	1
Laude	2	-	-	2
Oudeschans	1	-	-	1
Rhederbrug	1	-	-	1
Sellingen	4	-	-	4
Ter Apel	6	3	3	12
Veele	1	-	-	1
Veelerveen	1	-	-	1
Vlagtwedde	7	-	1	8
Vriescheloo	2	1	-	3
Wedde	2	1	-	3
Totaal	46	8	4	58
	<u>79%</u>	<u>14%</u>	<u>7%</u>	

Aanbevelingen

- a) Doordat de ambulancehulpverlening in Nederland zodanig is georganiseerd dat vanaf tijdstip melding op de 112 Meldkamer in Drachten, de ambulance maximaal vijftien minuten de tijd heeft om bij het slachtoffer te arriveren, is het in veel gevallen onmogelijk gebleken om binnen de zes minuten een reanimatie te starten. Voornamelijk de buitengebieden hebben langere aanrijtijden voor zowel de politie als ook de ambulancezorg. Met de toenemende vergrijzing van de bevolking in Zuidoost Groningen en een hoger percentage hart- en vaatziekten in dit gebied is het van essentieel belang dat binnen de gemeente Westerwolde verder wordt gewerkt aan het inrichten van een fijnmazig netwerk van zowel burgerhulpverleners als AED's. Hierbij moet ook aandacht worden gegeven aan de gebieden buiten de woonkernen.
- b) In overleg met de eigenaren, waaronder vijf scholen, de in pandige AED's naar buiten brengen.
- c) Het maken van nadere afspraken tussen de gemeente Westerwolde en de Stichting Hartveilig Westerwolde v.w.b. de kosten van het reguliere onderhoud van de huidige en toekomstige AED's.
- d) Afspraken met HartslagNu over het aanleveren van geregistreerde AED-locaties.

VOORWAARDEN

De doelstelling is het creëren van een 6-minuten zone in Westerwolde die moet voldoen aan de volgende 5 randvoorwaarden.



Beschikbaar

De AED moet op “IEDER” moment van de dag beschikbaar zijn.

Bereikbaar

De AED moet voor “IEDEREEN” bereikbaar zijn.

Draagvlak

Burgerhulpverleners in de directe omgeving met kennis, kunde en vaardigheden voor het gebruik van de AED.

Financieel

Het project moet financieel haalbaar zijn.

Continuïteit

Er moet sprake zijn van continuïteit in beheer en gebruik

Wilt u ons helpen in de realisatie van een levensreddend netwerk van AED's in Westerwolde en ons daarbij financieel ondersteunen, maak dan uw gift over naar NL65RBRB0918729610 t.n.v. Stichting Hartveilig Westerwolde.

SPONSOREN



ANBI

Stichting Hartveilig Westerwolde voldoet aan de eisen die de Nederlandse Belastingdienst stelt voor een 'algemeen nut beoogde instelling', oftewel ANBI. Deze goedkeuring is belangrijk omdat je als donateur alleen schenkingen kunt aftrekken van de belastingen als een organisatie voldoet aan de eisen van ANBI. Daarnaast betekent dat dat wij geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen.

Contact Info

Stichting Hartveilig Westerwolde
Email: kmevankooten@hotmail.com

Voorzitter: Henry Esman
Tel: 06-21828661

Penningmeester: Jan Potgraven
Tel: 06-25228973

Secretaris: Kim Waslander
Tel: 06-24384282

Lid: open vacature
Vraag voor meer informatie

KvK/RSIN-nummer:
855140069